


Betriebsstunden ablesen: Sauerstoffkonzentrator Typ InogenOne® G3 HF
14.24.06.1002

Oben-Schräg-Ansicht:




Display Ansicht:

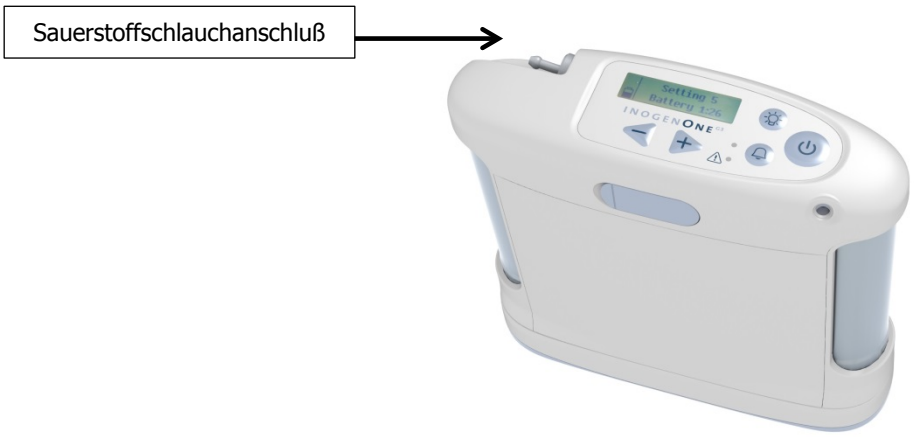

Auslesen:

Gerät **nicht** am Strom und einschalten (Hauptschalter)

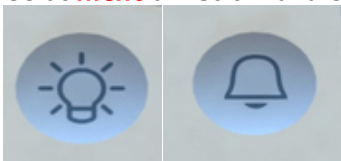

beide Tasten gleichzeitig lange drücken, bis ein Signalton ertönt.

Display-Anzeige: obere Zahl = Betriebsstunden (Beispiel: 123:00)
Unter Zahl = Firmware-version

